


MT 800

IB MT 800 S-V10 1923 - Revision Date: 2023-04-13

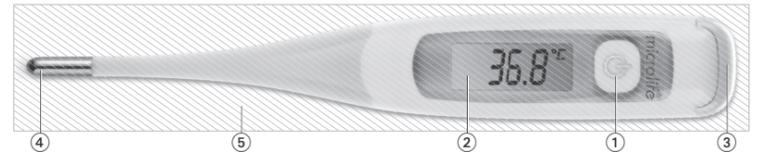

Description of this Thermometer

- ON/OFF button
- Display
- Battery compartment cover (back side)
- Measuring sensor / measuring tip
- Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

Important Safety Instructions

● Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.

● This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.

● Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.

● We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.

● The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

● Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring Methods / Normal body temperature».

● Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

● Ensure that children do not use this device un supervised; some parts are small enough to be swallowed.

● Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife-Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is **not a diagnosis!** Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.



Read the instructions carefully before using this device.

- Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button , a short beep signals «Thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display automatically for 2 seconds with the «m» icon. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear at the display field . The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button . 10 times the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Reviewing the last Measurement

When turning on the thermometer, the last measurement will be displayed with a «m» for memory.

Measuring methods / Normal body temperature

► **In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C**
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient’s arm next to the patient’s body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait **at least 5 minutes**, regardless of the beep sound.

► **In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C**
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 10 seconds!

► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Carefully insert the measuring sensor of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 10 seconds!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol) to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

For professional use: Additionally, you may apply probe covers (available as accessory). Contact Microlife for more details concerning further disinfectants for your thermometer model.

Battery Replacement

When the «» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover from the thermometer. Insert the new battery with the «+» at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications	
Type:	Maximum thermometer
Measurement range:	32.0 °C to 43.9 °C <p>Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low) Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)</p>
Measurement accuracy:	± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C <p>± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C</p>
Operating conditions:	10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Storage conditions:	-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Battery lifetime:	approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class:	IP67
Reference to standards:	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Expected service life:	5 years or 10000 measurements

microlife

Limpeza y desinfección

Para la desinfección en el entorno de uso doméstico, use un hisopo con alcohol isopropílico al 70% o un pañuelo de algodón humedecido con alcohol isopropílico al 70% para limpiar los contaminantes de la superficie de la sonda del termómetro. Siempre comienza a limpiar desde el extremo de la sonda del termómetro (aprox. En el medio del termómetro) hacia la punta del termómetro. Luego todo el termómetro(véase el número en el dibujo) debe sumergirse en alcohol isopropílico al 70% durante al menos 5 minutos (máx. 24 horas). Después de la inmersión, deje que el desinfectante se seque durante 1 minuto antes del próximo uso.

Para uso profesional: Además, puede aplicar cubiertas de sonda (disponibles como accesorio). Comuníquese con Microlife para obtener más detalles sobre otros desinfectantes para su modelo de termómetro.

Sustitución de la batería

Cuando el símbolo «» (triángulo con la punta hacia abajo) aparece en la pantalla, la pila está baja y necesita cambiarse. Para cambiar la pila, levante la tapa del compartimento de la pila del termómetro. Inserte la nueva pila de manera que el signo + quede mirando hacia arriba. Procure tener a mano una pila del mismo tipo. Las pilas se pueden comprar en cualquier tienda de electrónica.

Especificaciones técnicas	
Tipo:	Termómetro de máxima
Nivel de medición:	32.0 °C a 43.9 °C <p>Temp. < 32.0 °C: aparece «L» por low (demasiado baja) Temp. > 43.9 °C: aparece «H» por high (demasiado alta)</p>
Precisión de medición:	± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C <p>± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C y 42.1 - 43.9 °C</p>

Condiciones de funcionamiento:	10 - 40 °C; 15-95% de humedad relativa como máximo
Condiciones de almacenamiento:	-25 - +60 °C; 15-95% de humedad relativa como máximo
Batería:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Duración de la batería:	aprox. 4500 mediciones (usando una batería nueva)
Clase IP:	IP67
Referencia a los estándares:	EN 12470-3, termómetros clínicos; ASTM E1112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Vida útil esperada:	5 años o 10000 mediciones

Este dispositivo esta en conformidad con los requerimientos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Garantía

Este dispositivo está cubierto por una garantía de por vida a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, a nuestra discreción, Microlife reparará o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita.

La garantía no será válida si abre o manipula el dispositivo.

- Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:
 - Costos de transporte y riesgos del transporte.
 - Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.
 - Daño causado por fugas de baterías.
 - Daño causado por accidente o mal uso.
 - Material de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.
- «Comprobaciones periódicas y mantenimiento (calibración).
- «Accesorios y piezas de desgaste: Batería.

En caso de que se requiera un servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto o con su servicio local de Microlife. Puede ponerse en contacto con su servicio local Microlife a través de nuestro sitio web: www.microlife.com/support

La compensación se limita al valor del producto. La garantía se otorgará si el producto completo se devuelve con la factura original. La reparación o el reemplazo dentro de la garantía no prolonga ni renueva el período de garantía. Los reclamos y derechos legales de los consumidores no están limitados por esta garantía.

Description du thermomètre

- Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
- Ecran
- Couvercle du logement de la pile
- Capteur / embout de mesure
- Zone de nettoyage et de désinfection (toute la surface du thermomètre)

Importantes précautions d’emploi

- Respectez les instructions d’utilisation. Ce document fournit des informations importantes sur le fonctionnement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour mesurer la température du corps humain par voie orale, rectale ou axillaire. N’essayez pas de prendre la température sur d’autres parties, comme dans l’oreille, cela peut entraîner de fausses lectures et des lésions.
- N’utilisez pas cet appareil si l’est endommagé ou si vous remarquez quelque chose d inhabituel.
- Pour des raisons d’hygiène, nous recommandons de nettoyer cet appareil suivant les instructions ci-dessous avant toute utilisation.
- Toujours respecter la durée minimale de mesure en attendant que le bip retentisse.

Notez que pour certains endroits du corps, il faut attendre en continu la température même après le bip, lire la section «Méthodes de mesure / Température normale corporelle».

● Ne faites pas de prise par voie rectale sur des personnes souffrant de troubles rectaux. Cela pourrait aggraver les problèmes.

● Ne laissez jamais les enfants utiliser l’appareil sans surveillance; certaines de ses parties sont si petites qu’elles peuvent être avalées.

● Ne mettez pas l’appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par exemple à proximité de téléphones portables ou d’installations radio. Garder une distance minimale de 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.

- Veiller à ne pas laisser tomber l’instrument et à ne pas lui faire subir de choc!
- Évitez de plier l’embout flexible du thermomètre à plus de 45 °!
- Ne pas exposer l’instrument à des températures ambiantes supérieures à 60 °C. Ne JAMAIS faire bouillir l’instrument!
- Utilisez uniquement les désinfectants commerciaux répertoriés dans la section «Nettoyage et désinfection» pour nettoyer l’appareil afin d’éviter tout dommage à l’appareil.
- Nous recommandons de faire tester cet appareil pour vérifier sa précision tous les deux ans ou après un choc (par exemple en cas de chute). Veuillez contacter votre service local Microlife pour le test.

ATTENTION: La mesure délivrée par ce thermomètre ne constitue pas un diagnostic! Ne pas se fier uniquement au résultat de la mesure.

Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

Veillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser ce produit.



- Partie appliquée du type BF

Mise en marche du thermomètre

Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/OFF . Un bip court indique que le «thermomètre est en marche». Un test d’affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l’écran. La dernière mesure s’affiche à l’écran pendant 2 secondes avec le symbole «m».

Une température ambiante inférieure à 32 °C, un «L» s’affiche et un «°C» se met à clignoter sur l’écran . Le thermomètre est alors prêt à l’emploi.

Test de fonctionnement

Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque mise en marche. En cas d’anomalie de fonctionnement (imprécision de mesure), le message «ERR» s’affiche et la prise de mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le thermomètre.

Utilisation du thermomètre

Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et le symbole «°C» clignote. Si le bip retentit 10 fois et si le «°C» ne clignote plus, la température prédictive finale a été déterminée et le thermomètre peut être lu. 10 bips brefs retentissent quand la température est supérieure à 37.5 °C pour signaler un risque de fièvre. Référence: température orale.

Afin d’obtenir des résultats comparables, veuillez respecter 1 minute d’intervalle entre chaque mesure.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF . Pendant le thermomètre s’arrêtera automatiquement au bout d’environ 10 minutes de non utilisation.

Revoir la dernière mesure

Allumer l’appareil et la dernière mesure va apparaître à l’écran en même temps que le sigle «m» (M pour mémoire).

Méthodes de mesure / Température normale corporelle

► Température axillaire (sous l’aisselle) / 34.7 - 37.3 °C

Essuyez les aisselles avec une serviette sèche. Placez la sonde de mesure sous le bras au centre de l’aisselle de sorte que la pointe touche la peau et antioignez votre bras près du corps. Cela permet d’éviter que l’air ambiant n’influence la mesure. Car la prise de température sous aisselle prend plus de temps pour atteindre une température stable, aussi gardez cette position au moins **5 minutes**, quel que soit le bip sonore.

► Température buccale (dans la bouche) / 35.5 - 37.5 °C

Ne mangez rien ni ne buvez rien de chaud ou de froid dans les 10 minutes précédant la prise de température. Gardez la bouche fermée jusqu’à 2 minutes avant de commencer une lecture. Placer le thermomètre dans l’une des deux cavités situées à gauche ou à droite du frein de la langue. L’embout thermosensible doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d’affecter la prise de mesure par l’air aspiré/expiration.

Si cela n’est pas possible à cause des voies respiratoires bloquées, il faut utiliser une autre méthode de prise de température.

Mesure effectuée en 10 secondes environ!

► **Température rectale (dans le rectum) / 36.6 - 38.0 °C**
Introduire doucement l’embout d’un 2 à 3 cm dans le rectum.

L’utilisation d’un couvre-sonde et l’utilisation d’un lubrifiant sont recommandées.

Si vous ne vous sentez pas confiant pour le faire, rapprochez-vous d’un professionnel pour demander conseil.

Mesure effectuée en 10 secondes environ!

Nettoyage et désinfection

Pour une désinfection domestique, utilisez un tampon ou un mouchoir en coton imbibé d’alcool isopropyle à 70% pour enlever les polluants en surface de la sonde. Commencez toujours par la fin de la sonde du thermomètre (environ au milieu du thermomètre) et revenez vers la pointe. Ensuite, plongez toute la sonde (voir numéro sur le dessin) dans de l’alcool isopropyle à 70% pendant au moins 5 minutes (max. 24 heures). Après immersion, retirez et laissez sécher la sonde pendant 1 minute avant sa prochaine utilisation.

Pour un usage professionnel: De plus, vous pouvez utiliser des couvre-sondes (disponibles comme accessoire). Contactez Microlife pour plus de détails concernant d’autres désinfectants pour votre modèle de thermomètre.

Remplacement de la pile

Lorsque le symbole «» (triangle inversé) s’affiche, la pile est déchargée et doit être changée. Pour effectuer son remplacement, enlever le couvercle du logement de la pile du thermomètre. Insérer la nouvelle pile en veillant à bien orienter la borne positive (+) vers le haut. S’assurer d’utiliser une pile du même type. Les piles appropriées peuvent être achetées chez tout revendeur.

Caractéristiques techniques

Type:	Thermomètre à maxima
Plage de mesure:	32.0 °C à 43.9 °C <p>Un «L» s’affiche pour les températures inférieures à 32.0 °C Un «H» s’affiche pour les températures supérieures à 43.9 °C ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C ± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C et 42.1 - 43.9 °C</p>

Conditions d’utilisation:	10 - 40 °C; 15-95% d’humidité relative maximum
Conditions de stockage:	-25 - +60 °C; 15-95% d’humidité relative maximum
Pile:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Durée de vie des piles:	env. 4500 mesures (avec une pile neuve)
Clase IP:	IP67
Référence aux normes:	EN 12470-3, thermomètres médicaux; ASTM E1112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Durée de fonction-nement:	5 ans ou 10000 mesures

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux appareils médicaux 93/42/EEC.

Sous réserve de modifications techniques.

Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie à vie à compter de la date d’achat. Pendant cette période de garantie, à notre discrétion, Micro-life réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux. Le fait d’ouvrir ou de modifier l’appareil invalide la garantie. Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

- Frais de transport et risques de transport.
- Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect du mode d’emploi.
- Dommages causés par une fuite des piles.
- Dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.
- Matériel d’emballage / stockage et mode d’emploi.
- Contrôles et maintenance réguliers (étalonnage).

- Accessoires et pièces d’usure: pile.
- Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit à été acheté ou le bureau local Microlife.

Sous réserve de modifications techniques.

Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

● Frais de transport et risques de transport.

● Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect du mode d’emploi.

● Dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.

● Matériel d’emballage / stockage et mode d’emploi.

● Contrôles et maintenance réguliers (étalonnage).

● Accessoires et pièces d’usure: pile.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit à été acheté ou le bureau local Microlife.

Sous réserve de modifications techniques.

Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

● Frais de transport et risques de transport.

● Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect du mode d’emploi.

● Dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.

● Matériel d’emballage / stockage et mode d’emploi.

● Contrôles et maintenance réguliers (étalonnage).

● Accessoires et pièces d’usure: pile.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit à été acheté ou le bureau local Microlife.

Sous réserve de modifications techniques.

Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

● Frais de transport et risques de transport.

● Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect du mode d’emploi.

● Dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.

● Matériel d’emballage / stockage et mode d’emploi.

● Contrôles et maintenance réguliers (étalonnage).

● Accessoires et pièces d’usure: pile.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit à été acheté ou le bureau local Microlife.

Sous réserve de modifications techniques.

Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

Quand la température ambiante est inférieure a 32 °C comparará sul display («L» e in alto a destra una «°C» lampeggerà. Il termometro è ora pronto per l’uso.


Autotest di funzionamento

Il regolare funzionamento del termometro viene controllato ogni volta che si accende. Se nell’autotest di funzionamento viene individuata una disfunzione (innesatzata della misurazione), comparará «ERR» sul display e non sarà possibile procedere alla misurazione. In questo caso, il termometro deve essere sostituito.

Uso del termometro

MT 800

IB MT 800 S-V10 1923 - Revision Date: 2023-04-13

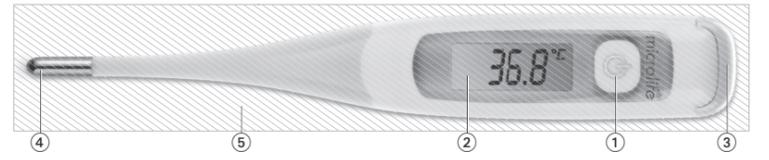

Descrição do termómetro

- Botão ON/OFF
- Visor
- Tampa do compartimento da pilha
- Sensor de Medição / Ponta de medição
- Zona de Limpeza e desinfecção (Toda a superfície do termómetro)

Instruções de segurança importantes

- Siga as instruções de uso. Este documento fornece informações importantes de manuseamento e segurança do produto em relação a este dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar o dispositivo e guarde-o para referência futura.
- Este dispositivo deve ser apenas usado apenas no corpo humano: via oral, retal ou axilar. Não tente fazer a medição da temperatura em qualquer outra zona, como as orelhas, pois pode resultar em leituras falsas e algum dano.
- Não utilize este dispositivo se achar que está danificado ou se observar algo anormal no dispositivo.
- Recomendamos limpar este dispositivo de acordo com as instruções de limpeza, antes da primeira utilização, para higienize pessoal.
- É necessário respeitar sempre o tempo de medição mínimo até o sinal sonoro ser emitido! Considerar que diferentes zonas de medição de temperatura requerem a contínua utilização mesmo após o som, «Métodos de medição / Temperatura corporal normal».
- Não procure medir a temperatura do reto de uma pessoa com problemas reiais. Pois pode levar a um agravamento da situação.
- Certifique-se de que não deixo o dispositivo ao alcance das crianças, algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas.
- Não utilize o dispositivo na proximidade de campos eletromagnéticos fortes, tais como, telemóveis ou instalações radiofónicas. Manter uma distância mínima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.
- Proteja o instrumento contra impactos e quedas!
- Evite dobrar a sonda do termómetro mais de 45°!
- Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o instrumento!
- Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfecção» para limpeza do dispositivo e de forma a evitar danos no mesmo.
- Recomendamos a que este dispositivo seja testado após 2 anos ou impato mecânico (ex.: cair no chão). Por favor, contate o representante da Marca Microlife para resolver a situação.

- **AVISO:** O resultado da medição fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado da medição. As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

- Peça aplicada tipo BF
- Ligar o termómetro**
- Para ligar o termómetro, pressione o botão ON/OFF (1); um breve sinal sonoro indica que o termómetro está ligado (ON). É efetuado um teste ao visor. Deverá visualizar-se todos os ícones.
- A última medição efetuada será indicada no visor (2) automaticamente durante 2 segundos com o ícone «M».
- Em seguida, a uma temperatura ambiente inferior a 32 °C, são apresentados os símbolos «L» e «°C» a piscar no mostrador (2). O termómetro pode agora ser utilizado.

Teste de funcionamento

O funcionamento correto do termómetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer anomalia (medição incorreta), o visor indicará a informação «ERR», ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termómetro.

Utilização do termómetro

Escolha o modo de medição pretendido. Ao efectuar uma medição, a temperatura actual é exibida continuamente e o símbolo «°C» é apresentado a piscar. Se ouvir o sinal sonoro 10 vezes e o símbolo «C» deixar de piscar, o valor final da temperatura foi determinado e é possível ler-se agora o resultado final.

São emitidos 10 breves sinais sonoros quando a temperatura for superior a 37,5 °C para avisar o paciente de que poderá ter febre.

Reverendo a última medição

Ao ligar o termómetro, a última medição será exibida junto com um «M» que significa a memória.

Métodos de medição / Temperatura corporal normal

► **Debaixo do braço (axilar) / 34,7 - 37,3 °C**
Higienize a axila com uma toalha seca. Coloque o sensor de medição (2) sob o braço no centro da axila, de modo que a ponta do dispositivo toque na pele, e posicione o braço próximo ao corpo. Isso garante que o ar do ambiente não afete a leitura. Porque a temperatura na axila, leva mais tempo para atingir uma temperatura estável, deste modo deve aguardar pelo **menos 5 minutos**, independentemente do sinal sonoro.

► **Na boca (oral) / 35,5 - 37,5 °C**
Não ingira ou beba algo quente ou frio 10 minutos antes da medição. A boca deve manter-se fechada 2 minutos depois do começo da leitura.

Coloque o termómetro num dos lados sob a língua, à esquerda ou à direita do freio da língua. O sensor de medição (2) tem de estar em contacto com a mucosa. Feche a boca e respire normalmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pela inspiração/ expiração.

Se isso não for possível devido a vias aéreas bloqueadas, outro método de medição deve ser utilizado.

No tempo de medição aproximado: 10 segundos!

► **Anus (rectal) / 36,6 - 38,0 °C**
Introduza cuidadosamente o sensor de medição (2) do termómetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

Recomenda-se a utilização de uma tampa de sonda (descartável) e a utilização de um lubrificante.

Caso não tenha certeza de como realizar este método de medição, consulte um profissional de saúde para obter ajuda.

Tempo de medição aproximado: 10 segundos!

Para **desinfecção** profissional: Adicionalmente, pode aplicar as tampas da sonda (disponíveis como acessórios). Entre em contato com a Microlife para obter mais detalhes sobre outros desinfetantes para o modelo do seu termómetro.

Substituição da pilha

Quando o símbolo « ▽ » (triângulo invertido) for apresentado no mostrador a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento da pilha (3) do mostrador. Introduza a nova pilha colocando o sinal « ▽ » para cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

Especificações técnicas

Para definição do dispositivo em casa, utilize um cotoneco com álcool isopropílico 70% ou com um algodão húmido com 70% álcool isopropílico para limpar sujidade da sonda e da superfície do termómetro ao longo do seu comprimento. De seguida, o termómetro (ver imagem 6) deve ser imerso em álcool isopropílico 70%, pelo menos 5 minutos (máx. 24 horas). Após imersão, deise o desinfetante secar 1 minuto antes do próximo uso.

► **Para utilização profissional:** Adicionalmente, pode aplicar as tampas da sonda (disponíveis como acessórios). Entre em contato com a Microlife para obter mais detalhes sobre outros desinfetantes para o modelo do seu termómetro.

Substituição da pilha

Quando o símbolo « ▽ » (triângulo invertido) for apresentado no mostrador a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento da pilha (3) do mostrador. Introduza a nova pilha colocando o sinal « ▽ » para cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

Especificações técnicas

Termómetro de máxima
32,0 °C a 43,9 °C
Temperatura de visualização
o símbolo «L» correspondente a temperatura baixa (demasiado baixa)
Temperatura de visualização
o símbolo «H» correspondente a temperatura elevada (demasiado elevada)
Precisão da medição:
±0.1°C; 34 °C -42 °C
±0.2 °C; 32,0 - 33,9 °C e 42.1 - 43.9 °C

Meettijd ca.: 10 seconden!

► **Anus (rectal) / 36,6 - 38,0 °C**
Brenng de meetSENSOR van de thermometer (2) voorzichtig 2 tot 3cm in de anaalopening.

Het gebruik van een beschermkapje en het gebruik vaseline wordt aanbevolen.

Als u niet zeker bent van deze meetmethode, dient u een professional in te raadplegen voor begeleiding / training.

Meettijd ca.: 10 seconden!

► **Reinigen en desinfecteren**

Gebruik voor desinfectie in een thuisomgeving een waterstaafje met 70% isopropylalcohol om vuil van de thermometer sonde te verwijderen. Veeg altijd vanaf het uiteinde van de sonda van de thermometer (ongeveer in het midden van de thermometer) naar de punt van de thermometer. Daarna moet de hele thermometer (zie nummer 5) in de tekening) gedurende ten minste 5 minuten (max. 24 uur) worden ondergedompeld in 70% isopropylalcohol. Na onderdompeling, laat het desinfectiemiddel 1 minuut drogen voor het volgende gebruik.

► **voor professioneel gebruik:** Daarnaast kunt u beschermkapsjes aanbrengen (verkrijgbaar als accessoire). Neem hiervoor en meer informatie over desinfectiemiddelen betreffende u thermometer model contact op met Microlife.

Batterijvervangng

► Wanneer het symbool « ▽ » verschijnt op het display, is de batterij leeg en moet deze worden vervangen. Om de batterij te vervangen moet het dekselje van het batterijvakje worden verwijderd (3). Plaats een nieuwe batterij met de « ▽ » aan de bovenzijde. Zorg ervoor dat u een batterij van hetzelfde type bij de hand heeft. Batterijen kunnen in bijna alle electronicawinkels worden gekocht.

► **Technische specificaties**

Type: Maximum thermometer
32,0 °C tot 43,9 °C
Meetbereik: 32,0 °C - 43,9 °C
Temperatuur display «L» voor laag (te laag)
Temperatuur display «H» voor hoog (te hoog)
± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C e 42.1 - 43.9 °C

► **Werkingsocondities:**
10 - 40 °C; 15-95 % maximale relatieve vochtigheid
► **Bevoorradingstoestand:**
-25 - 60 °C; 15% maximaale relatieve vochtigheid
► **Batterij:**
LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
► **Levensduur batterij:**
ongeveer 4500 metingen (met een nieuwe batterij)
► **IP Klasse:**
IP67

► **Verwijzing naar normen:**
EN 12470-3, klinische thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-1

Verwachte levensduur:

Dit apparaat komt overeen met de normen van de richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

Garantie

Dit apparaat heeft een levenslange garantie vanaf de aankoopdatum. Tijdens deze garantieperiode zal Microlife het defecte product gratis repareren of vervangen.

Opening van de wijzigingen aan het apparaat maakt de garantie ongeldig. De volgende items zijn uitgesloten van garantie:

- Transportkosten en transportrisico's.
- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.
- Schade veroorzaakt door lekkende batterijen.
- Schade veroorzaakt door vallen of verkeerd gebruik.
- Verpakkings- / opslagmateriaal en gebruiksaanwijzing.
- Regelmatige controles en onderhoud (kalibratie).
- Accessoires en verbruiksmaterialen: Accu.

Mocht garantieservice nodig zijn, neem dan contact op met de dealer waar u het product hebt aangekocht of met de service afdeling van Microlife via onze website:

De vervoeding is beperkt tot de waarde van het product. De garantie wordt verleid als het volledige product wordt getrouweerd met de originele factuur. Reparatie of vervanging binnen de garantie verlengt de garantieperiode niet. De wettelijke claims en rechten van consumenten zijn niet beperkt door deze garantie.

- Perigrafo do termómetro**
- Πλήκτρο ON/OFF**
- Οθόνη**
- Κάλυμμα θήκης μπαταρίας**
- Αυθηθής μέτρησης / άκρο μέτρησης**
- Περιώχη καθαρισμού και απολύμανσης (ολόκληρη η επιφάνεια του θερμομέτρου)**

- Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας**
- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τηλέτη και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε το ως μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και απολύμανσης μέσω του στόματος, του ορθού ή της μασχάλης.** Μην επιχειρήσετε να πάρετε θερμοκρασία από άλλα στοιχεία, όπως στο αυτί, καθώς μπορεί να προκύψουν ψευδή αποτελέσματα μέτρησης και είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.** Αυτό το έγγραφο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος και την ασφάλεια αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε